



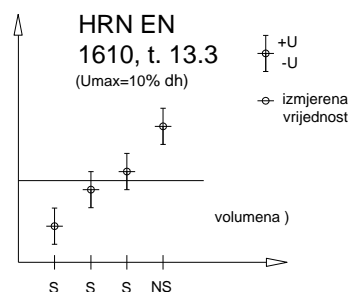



## IZJAVA O SUKLADNOSTI – PRAVILO ODLUČIVANJA

Temeljem rezultata dobivenih ispitivanjem laboratorij daje izjavu o sukladnosti i pritom primjenjuje sljedeće:

MJERNA NESIGURNOST	Pri razmatranju zadovoljenja rezultata postavljenim zahtjevima uzet će se u obzir utjecaj mjerne nesigurnosti s 95%-tnom vjerojatnošću pokrivanja za proširenu mjernu nesigurnost (faktor pokrivanja, $k=2$ )
PRAVILO ODLUČIVANJA	-Tamo gdje je mjerni rezultat zajedno s proširenom mjernom nesigurnosti <u>unutar postavljenih granica i presijeca postavljene granice</u> , izjavit će se sukladnost u obliku: <b>zadovoljava</b> ; -Tamo gdje je mjerni rezultat zajedno s proširenom mjernom nesigurnošću <u>izvan postavljenih granica</u> , izjavit će se nesukladnost u obliku: <b>ne zadovoljava</b>



### TUMAČ:

S – sukladno

NS – nesukladno

U max – maksimalno dopuštena proširena mjerna nesigurnost